


URZĄDZENIA SPRZĘT I NARZĘDZIA MEDYCZNE ORAZ ORTOPEDYCZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-81
	Narzędzia medyczne Odgryzacz kostny typ Luer-Stille z dźwignią, odgięty o pyszczkach wąskich	5912-13
		Zamiast BN-65/5912-13
		Grupa katalogowa 1421

**1. Przedmiot normy.** Przedmiotem normy jest odgryzacz kostny typ Luer-Stille z dźwignią, odgięty, o pyszczkach wąskich, używany przy zabiegach chirurgicznych.

**2. Oznaczenie**

ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER STILLE Z DŹWIGNIĄ, ODGIĘTY, O PYSZCZKACH WĄSKICH BN-81/5912-13

**3. Główne wymiary w mm — wg rysunku.**

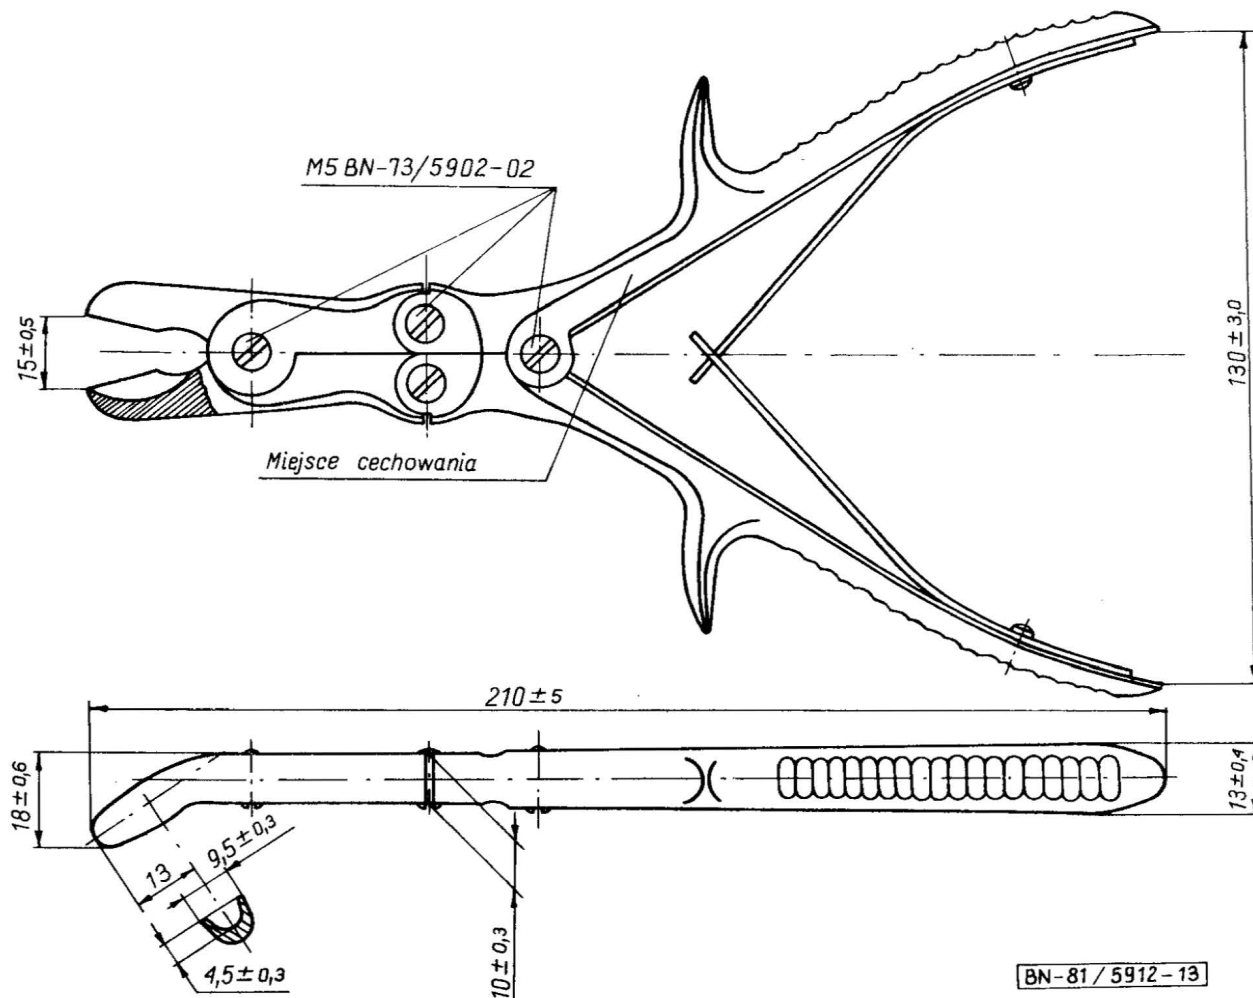

**4. Działanie.** Opór w zamku przy włączonej sprężynie, powstający w czasie zamykania i otwierania odgryzacza nie może być większy od siły wynoszącej 5 N, przyłożonej na końcu rękojeści prostopadle do osi symetrii odgryzacza. Siła potrzebna do całkowitego zamknięcia odgryzacza, przyłożona na końcu rękojeści prostopadle do osi symetrii odgryzacza, nie powinna przekraczać 15 N.

**5. Pozostałe wymagania i badania — wg PN-74/Z-54122.**

Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej  
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego dnia 20 stycznia 1981  
jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1981  
(Dz. Norm. i Miar nr 5 poz.26)

**INFORMACJE DODATKOWE**

**1. Instytucja opracowująca normę** — Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej w Warszawie.

**2. Istotne zmiany w stosunku do BN-65/5912-13**

- a) zmieniono wielkość rozwarcia rękojeści,
- b) uaktualniono jednostkę siły,
- c) określono tolerancje wymiarowe.

**3. Normy związane**

PN-74/Z-54122 Narzędzia medyczne. Odgryzaczę kostne. Wspólne wymagania i badania

BN-73/5902-02 Narzędzia medyczne. Wkręty. Wymiary