

WYROBY CFRAMICZNE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-89 7026-03
	Porcelanowy sprzęt laboratoryjny Łódeczki do spalań	Zamiast BN-68/7026-03
		Grupa katalogowa 0813



**1. Przedmiot normy.** Przedmiotem normy są łożeczki porcelanowe do spalań, stosowane głównie w analizach chemicznych do oznaczania siarki i węgla.

**2. Typy.** W zależności od wykończenia powierzchni, rozróżnia się łożeczki szklione (szkl.) i nieszkliwione (bez wyróżnika w oznaczeniu).

**3. Przykład oznaczenia łożeczki do spalań, szklionej, o długości 82 mm (wielkość 4):**

ŁÓDECZKA DO SPALANÍ szkl. 4 BN-89/7026-03

**4. Kształt i wymiary w mm — wg rysunku i tablicy.**

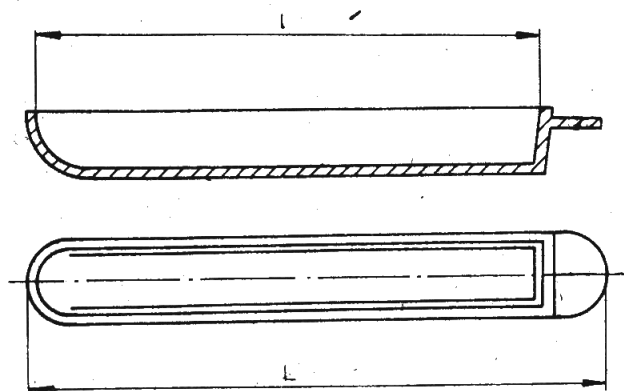

BN-89/7026-03

Wielkość	L	l	A	a	H	S
1	37 ±2	30 ±2	5 ±1	3 ±1	5 ±1	0,7 ÷ 1,0
2	47 ±2	40 ±2	7 ±1	4 ±1	6 ±1	
3	67 ±3	60 ±3	9 ±1	5 ±1	6 ±1	1,5 ÷ 2,5
4	82 ±4	75 ±3	12 ±1	8 ±1	9 ±1	
5	107 ±5	100 ±4	15 ±1	10 ±1	12 ±1	2 ÷ 3
6	125 ±6	118 ±5	16 ±1	12 ±1	14 ±1	

**5. Wady niedopuszczalne.** Na powierzchni głównej łożeczek nie dopuszcza się następujących wad:

- nakłuc skupionych, powodujących skorupkowatość szkliva,
- zaproszeń niezaszkliwionych,
- łysin,
- pęcherzy,
- wytopów,
- pęknięć powierzchniowych i włoskowatych.

**6. Pozostałe wymagania — wg PN-78/B-12330.**

**7. Pakowanie, przechowywanie i transport — wg PN-78/B-12330.**

**8. Badania — wg PN-78/B-12330.**

K O N I E C

#### INFORMACJE DODATKOWE

**1. Instytucja opracowująca normę —** Instytut Szkła i Ceramiki, Warszawa.

**2. Istotne zmiany w stosunku do BN-68/7026-03.** Doprowadzono do zgodności z PN-78/B-12330.

**3. Normy związane**

PN-78/B-12330 Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. Wymagania i badania

Zgłoszona przez Instytut Szkła i Ceramiki  
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Szkła i Ceramiki dnia 16 stycznia 1989 r.  
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1990 r.  
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1989, poz. 18)

10,-